630智能温湿度测试仪

［版本号：2209V01］

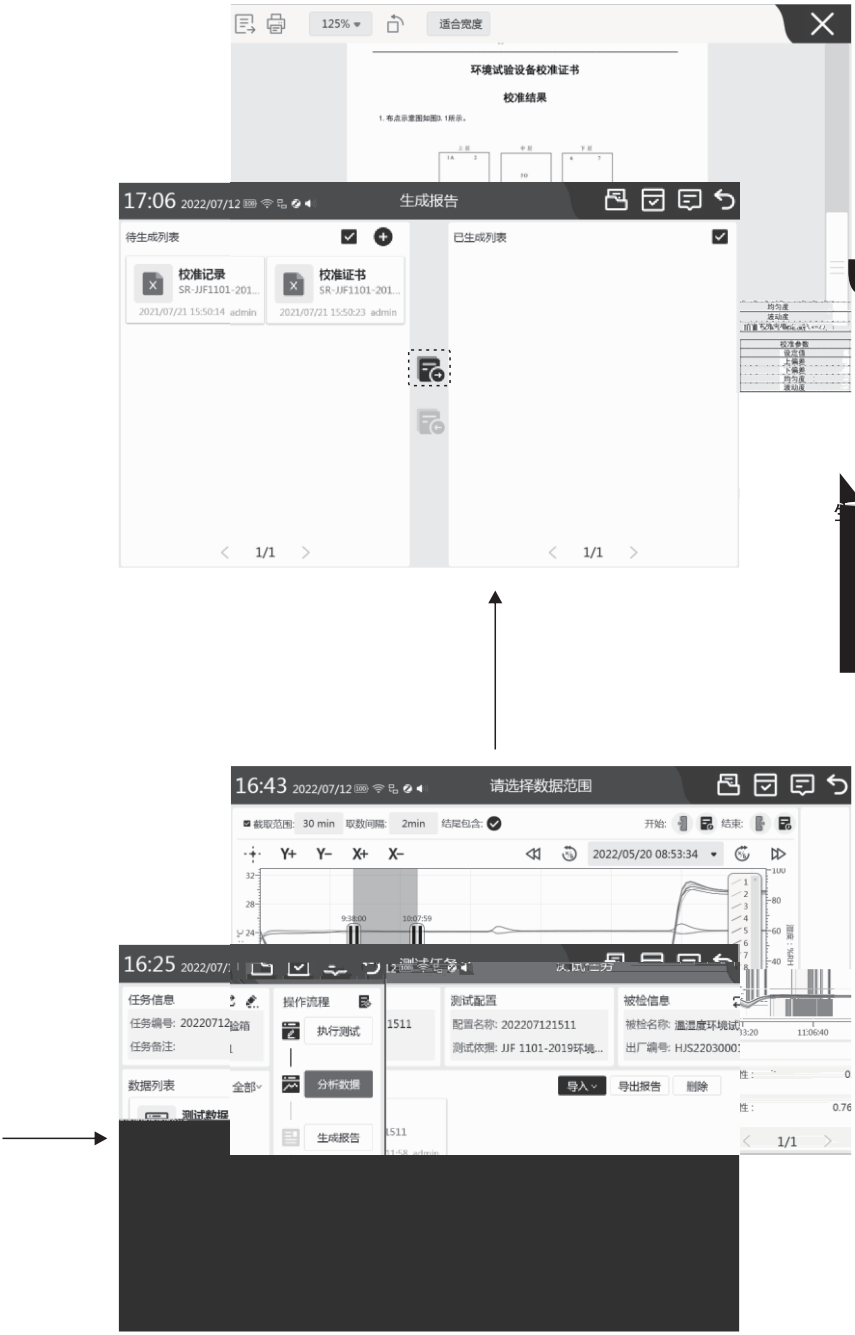
125%
适合宽度
环境试验设备校准证书
校准结果
17:06 2022/07/12
生成报告
待生成列表
校准记录
SR-JJF1101-201...
2021/07/21 15:50:14 admin
校准证书
SR-JJF1101-201...
2021/07/21 15:50:23 admin
已生成列表
1/1
1/1
16:43 2022/07/12
请选择数据范围
截取范围: 30 min
取数间隔: 2min
结尾包含:
开始:
结束:
Y+ Y- X+ X-
2022/05/20 08:53:34
9:38:00
10:07:59
16:25 2022/07/
任务信息
任务编号: 20220712
任务备注:
操作流程
执行测试
分析数据
生成报告
测试配置
配置名称: 202207121511
测试依据: JJF 1101-2019环境...
被检信息
被检名称: 温湿度环境试...
出厂编号: HJS2203000
导入
导出报告
删除
数据列表
全部
1/1

开始:
结束:
适合宽度
环境试验设备校准证书
校准结果
1. 布点示意图如图3.1所示。
图3.1布点示意图
2. 校准结果
2 / 2

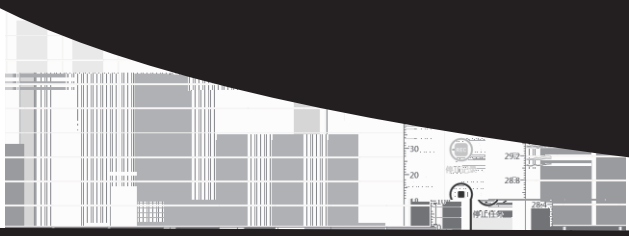

典型工作方式（二）

NO:1 2022/03/10 15:03
创建任务
记录编号*
202203101503
备注
扫描间隔
记录间隔
1s
快
手动
手动
选择通道
CH1,CH2,CH3,CH4,CH101

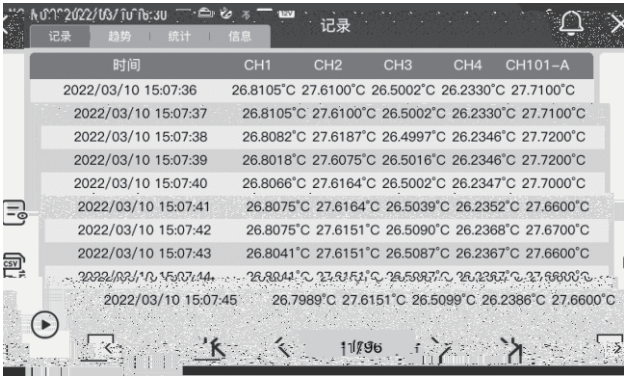
记录
记录
趋势
统计
信息
时间 CH1 CH2 CH3 CH4 CH101-A
2022/03/10 15:07:36 26.8105°C 27.6100°C 26.5002°C 26.2330°C 27.7100°C
2022/03/10 15:07:37 26.8105°C 27.6100°C 26.5002°C 26.2330°C 27.7100°C
2022/03/10 15:07:38 26.8082°C 27.6187°C 26.4997°C 26.2346°C 27.7200°C
2022/03/10 15:07:39 26.8018°C 27.6075°C 26.5016°C 26.2346°C 27.7200°C
2022/03/10 15:07:40 26.8066°C 27.6164°C 26.5002°C 26.2347°C 27.7000°C
2022/03/10 15:07:41 26.8075°C 27.6164°C 26.5039°C 26.2352°C 27.6600°C
2022/03/10 15:07:42 26.8075°C 27.6151°C 26.5090°C 26.2368°C 27.6700°C
2022/03/10 15:07:43 26.8041°C 27.6151°C 26.5087°C 26.2367°C 27.6600°C
2022/03/10 15:07:45 26.7989°C 27.6151°C 26.5099°C 26.2386°C 27.6600°C

创建校准任务

选择校准
目标探头

连接温源/
标准器

执行探头
校准

下载数据至
探头内部存储

让检测更轻松

北京康斯特仪表科技股份有限公司
网址：www.constgroup.com
电话：010-56973333

用户手册下载